

Information zu nicht verrechenbaren Laboranalysen

Ihr Laborsystem kann unter anderem Parameter bestimmen, welche über offizielle Tarifpositionen verfügen, aber nicht im Rahmen der Analysenliste Grundversorgung abrechenbar sind.

Zu diesen Analysen gehören u.a., aber nicht abschliessend, folgende Tarifpositionen:

Klinische Chemie:

1223.00	CA	Calcium
1518.00	LDH	Lactatdehydrogenase
1521.00	LDLC	LDL-Cholesterin
1556.00	MG	Magnesium
1537.00	LIPA	Lipase
1601.00	PHOS	Phosphor
1509.00	CREAU	Creatinin im Urin

Elektrolyte:


1574.00	NA	Natrium
1229.00	CL	Chlorid

Die Durchführung und / oder Verrechnung jeglicher Labor-Parameter liegt alleine in der Verantwortung des Arztes / der Praxis.


Damit ausgewählte Analysen nicht automatisch verrechnet werden, kann die Verrechnung im Laborstamm von Axenita deaktiviert werden (siehe untenstehende Anleitung).

Axonlab übernimmt bei falscher Verrechnung keine Haftung im Falle von Rückweisungen, Rückforderungen oder entgangenem Umsatz.

Anleitung zur Deaktivierung der Verrechnung

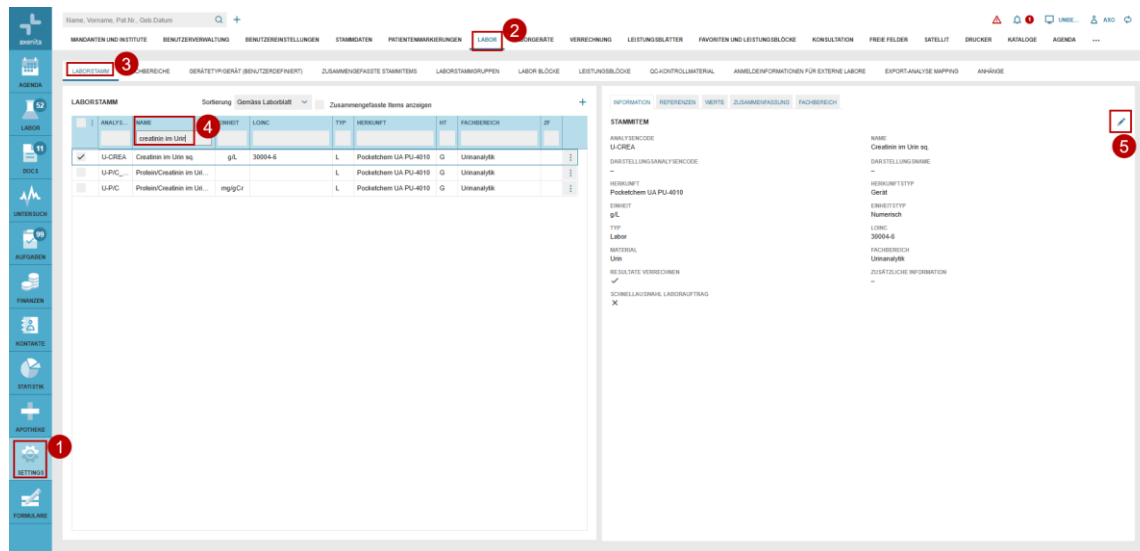

1. Modul: Settings
2. Register: Labor
3. Unterregister: Laborstamm
4. Laboranalyse suchen
5. Auf den Bearbeitungsstift klicken

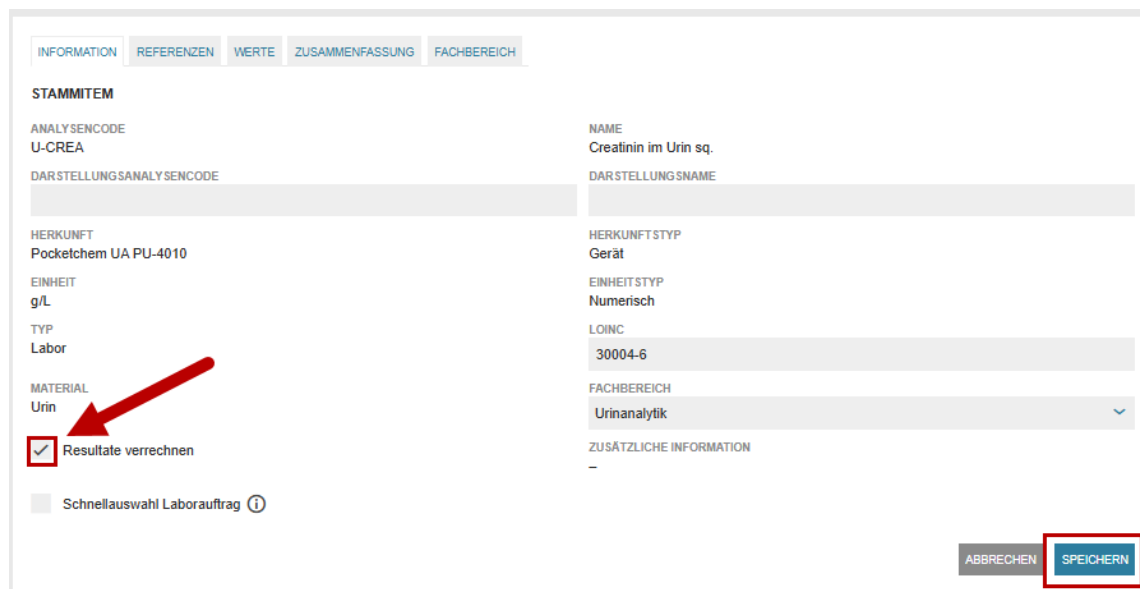

Entfernen Sie den Haken bei der Checkbox „Resultat verrechnen“ und speichern Sie die Änderung.